



Ensemble de filtres pour la configuration GCaMP

Note d'application


2021 DORIC LENSES INC

357 rue Franquet - Québec, (Québec)
G1P 4N7, Canada

Téléphone : 1-418-877-5600 - Fax : 1-418-877-
1008 1-418-877-5600 - Fax : 1-418-877-1008

www.doriclenses.com

Microscope à fluorescence de base : ensemble de filtres pour l'excitation GCaMP

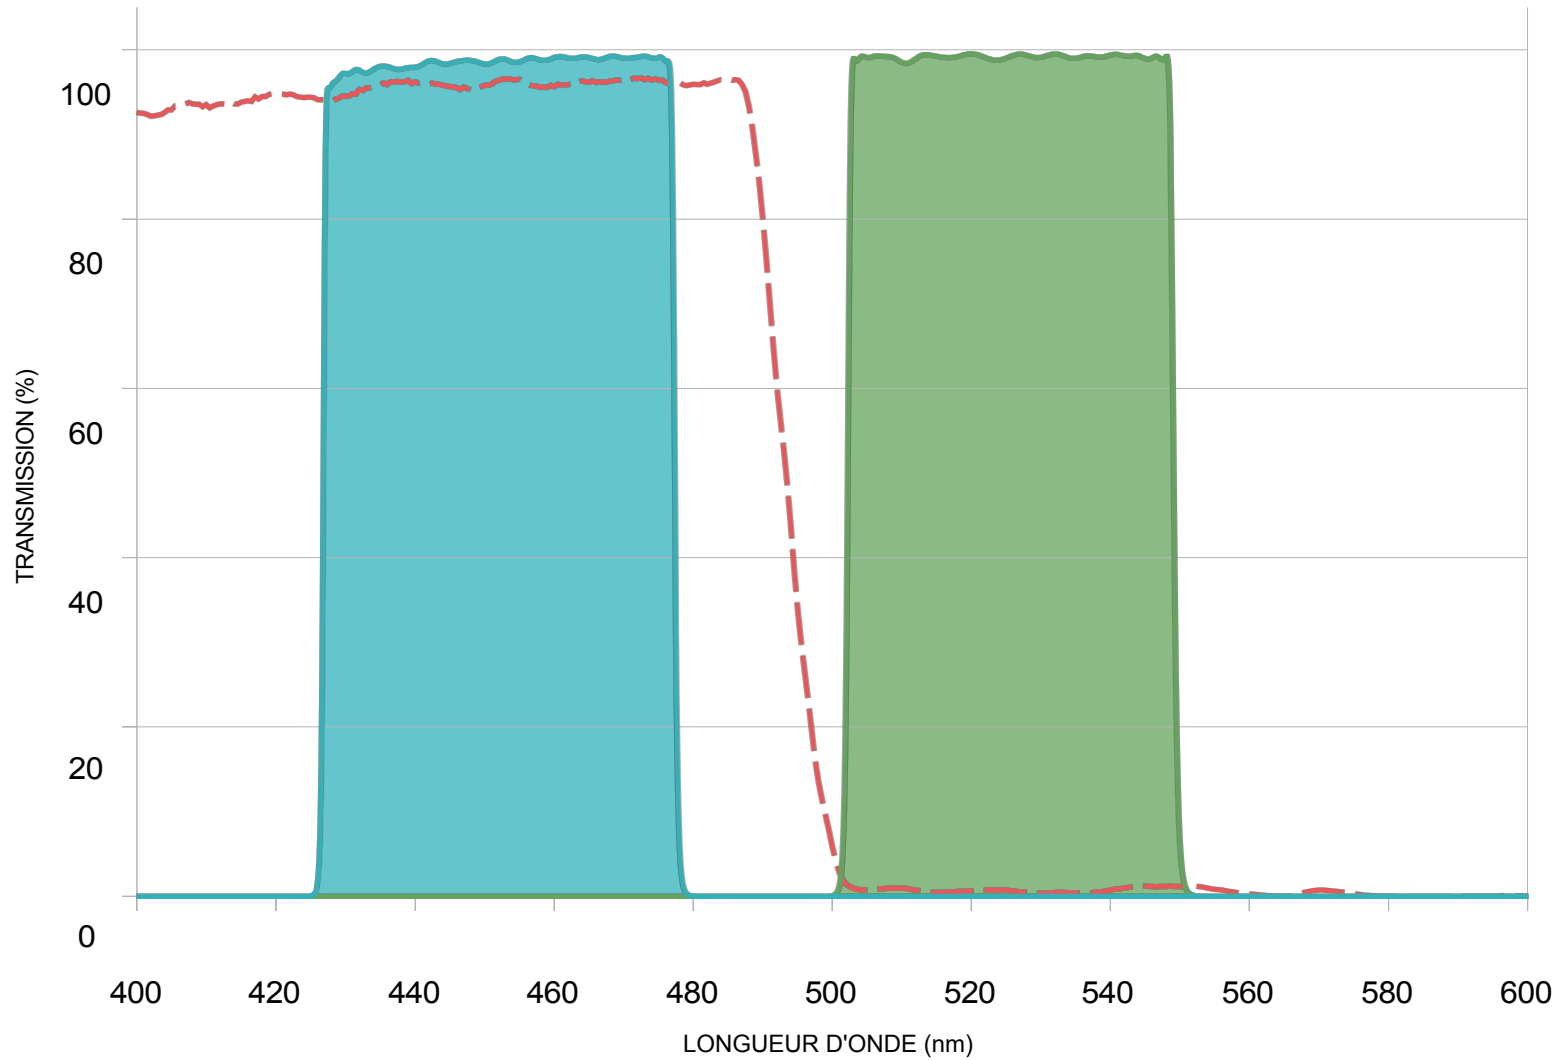

doric

--- FILTRE DICHROÏQUE

■ EXCITATION

■ ÉMISSION

DIAGRAMME DE L'ENSEMBLE DE FILTRES POUR MICROSCOPE DE BASE

